



ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д. А. МАКАРЕНКО
подпись инициалы, фамилия

15 ФЕВ 2019

Приложение
к аттестату об аккредитации
№ RA.RU.311486
от « 02 » февраля 20 16 г.

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай» (ФБУ «Алтайский ЦСМ»)

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

Горно-Алтайский филиал ФБУ «Алтайский ЦСМ»
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Объездная, д.3

адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности

Проверка средств измерений


АТ

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения механических величин				
1.	Весы лабораторные общего назначения	(0,001 – 1,5) кг	КТ (1 – 4)	
2.	Весы лабораторные электронные	(0,001 – 1,5) кг	КТ специальный КТ высокий КТ средний	



1	2	3	4	5
3.	Весы электронные (с регистрацией массы и цены, настольные, напольные платформенные, медицинские, модули взвешивающие)	(0,005 – 600) кг	КТ средний КТ обычный	
4.	Весы рычажные (настольные гирные, циферблатные, почтовые, передвижные платформенные, медицинские)	(0,005 – 600) кг	КТ средний КТ обычный	
5.	Весы маслопробные	(5 – 10) г	ПГ ±5 мг	
6.	Весы крутильные (торсионные)	(10 – 500) мг	ПГ ±(0,01 – 1) мг	
7.	Гири	(0,5 – 5) кг	КТ М ₂ ; КТ М ₃	
8.	Дозаторы весовые дискретного действия	(20 – 600) кг	КТ (0,1 – 2,5)	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
9.	Колонки топливораздаточные	(40 – 160) л/мин	ПГ ±(0,25 – 0,5) %	
10.	Мерники металлические эталонные	(10 – 500) дм ³	2 разряд	
Измерения давления, вакуумные измерения				
11.	Манометры показывающие	(0 – 6) МПа	КТ (0,5 – 4)	
12.	Манометры деформационные образцовые с условными шкалами	(0 – 6) МПа	КТ (0,15 – 1,0)	
13.	Сфигмоманометры, измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, полуавтоматические, механические	(0 – 300) мм рт.ст.	ПГ ±3 мм рт. ст.	
14.	Манометры кислородные показывающие	(0 – 6) МПа	КТ (1,5-4)	



1	2	3	4	5
Измерения электротехнических и магнитных величин				
15.	Счетчики электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные (индукционные, электронные)	(0 – 100) А (0 – 380) В 50 Гц	КТ (0,5 – 2)	




Исполнитель: И.И. Романов, директор ФБУ «Алтайский ЦСМ»

Е.В. Романов


Эксперт по аккредитации

 А.А. Куцобин

Технический эксперт

 Ю.В. Кучмей


Технический эксперт

 В.В. Киселев


Технический эксперт


 Т.Ю. Шиянова

Технический эксперт

 О.Г. Мельников

Технический эксперт

 И.И. Рыбачев

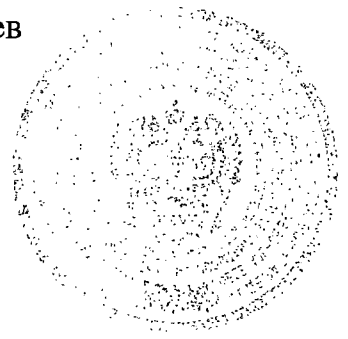

Прошито и пронумеровано

листов